Brugsanvisning

CE
0297

proxeo

Håndstykke
HP-44 M / HP-44 T / HP-44 TS / HP-44 T MW / HP-44 T SD

Vinkelstykker
WP-64 M / WP-64 MU / WP-66 M / WP-64 T / WP-64 TS

Indholdsfortegnelse

Symboler 4
- i brugsanvisningen 4
- på det medicinske udstyr/på emballagen 5

1. Indledning 6

2. Sikkerhedsanvisninger 9

3. Produktbeskrivelse 11

4. Ibrugtagning 12
- Påsætning/aftagning 12
- Udskiftning af det roterende instrument 15
- Testkørsel 23

5. Hygiejne og vedligeholdelse 24
- Generelle instruktioner 24
- Begrænsning i forbindelse med oparbejdningen 26
- Den første behandling på brugsstedet 27

Manuel rengøring 28
Manuel desinfektion 29
Maskinel rengøring og desinfektion 30
Tørring 31
Kontrol, vedligeholdelse og afprøvning 32
Emballage 36
Sterilisering 37
Opbevaring 40

6. Service 41

7. Tilbehør, forbrugsmaterialer, reservedele og andet anbefalet medicinsk udstyr fra W&H 42

8. Tekniske data 43

9. Bortskaffelse 45

Garantibevis 46

Autoriseret W&H-servicepartner 47

ADVARSEL!
(Risiko for personskade)

OBS!
(Risiko for tingskade)

Almene oplysninger,
uden fare for
mennesker eller ting

Må ikke bortskaffes
sammen med
husholdningsaffaldet

Må ikke genbruges

Symboler

på det medicinske udstyr/på emballagen

CE 0297 — CE-mærkning med identifikationsnummeret på det notificerede organ

REF — Varenummer

SN — Serienummer

Produktionsdato

Producent

Bemærk brugsanvisningen

DataMatrix Code til produktinformation inklusive UDI (Unique Device Identification)

135°C — Kan steriliseres op til den anførte temperatur

Kan termodesinficeres

HIBC — Datastruktur i henhold til Health Industry Bar Code

MD — Medicinsk udstyr

c UL us — UL-kontrolmærke for anerkendte dele for Canada og USA

℞ only — Forsigtig! I henhold til amerikansk lovgivning er salg af dette produkt kun tilladt af eller på ordinering af en tandlæge, en læge, en dyrlæge eller andet sundhedsfagligt personale med en licens i den amerikanske stat, hvor lægen praktiserer, og hvor dette produkt skal anvendes.

1. Indledning

Kundernes tilfredshed har højeste prioritet i W&H's kvalitetspolitik. Det foreliggende medicinske udstyr er udviklet, fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med de gældende standarder og lovmæssige bestemmelser.

For din egen og dine patienters sikkerhed
Inden apparatet tages i brug første gang, bedes du læse brugsanvisningen. I den forklares det, hvordan du håndterer det medicinske udstyr, så du sikrer dig fejlfri funktion samt økonomisk og sikker behandling.

Følg sikkerhedsanvisningerne.

Anvendelsesområder
Proxeo hånd-/vinkelstykket anvendes til at rense og polere tandoverfladen og fyldninger.

Enhver anden brug kan beskadige det medicinske udstyr og herved medføre risici og fare for patienten, brugeren og tredjemand.

Brugerens kvalifikationer
Vi har udviklet og fremstillet det medicinske udstyr med henblik på målgruppen tandlæger, tandhygiejnikere, tandmedicinsk fagpersonale (profylakse) og tandmedicinske fagassistenter.

Producentens ansvar
Producenten kan kun tage ansvaret for påvirkningerne på det medicinske udstyrs sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, når nedenstående anvisninger overholdes:

- Det medicinske udstyr skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
- Det medicinske udstyr har ingen dele, som kan repareres af brugeren.
- Ændringer eller reparationer må kun udføres af en autoriseret W&H-servicepartner (se side 47).

Sagkyndig anvendelse
Det medicinske udstyr er kun beregnet til sagkyndig anvendelse i henhold til anvendelsesområderne og i overensstemmelse med de gældende forskrifter for arbejdsbeskyttelse og forholdsregler til forebyggelse af ulykker samt under overholdelse af denne brugsanvisning.

Det medicinske udstyr må kun oparbejdes og vedligeholdes af personer, der er instrueret i infektions-, selv- og patientbeskyttelse.

Usagkyndig brug (f.eks. på grund af manglende hygiejne og vedligeholdelse), tilsidesættelse af vores anvisninger eller brug af tilbehør og reservedele, der ikke er godkendt af W&H, fritager os fra enhver form for garantiydelse eller andre krav.

Alle alvorlige hændelser, der er forekommet i forbindelse med det medicinske udstyr, skal indberettes til producenten og de ansvarlige myndigheder!

2. Sikkerhedsanvisninger

- > Opbevar det medicinske udstyr ved stuetemperatur i 24 timer inden første ibrugtagning.
- > Driften af det medicinske udstyr er kun tilladt sammen med forsyningsenheder, der opfylder standarderne IEC 60601-1 (EN 60601-1) og IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2).
- > Brug kun luft, der er oparbejdet i dentalkompressorer, filtreret, oliefri og afkølet som køleluft.
- > Sørg altid for at arbejde med korrekte driftsbetingelser.
- > Kontrollér altid det medicinske udstyr for beskadigelse og løse dele før hver anvendelse.
- > Tag ikke det medicinske udstyr i brug, hvis det er beskadiget.
- > Foretag en testkørsel før hver anvendelse.

Hygiejne og vedligeholdelse inden første brug

> Det medicinske udstyr leveres indsvejset i PE-folie og ikke-steril.
> PE-folien og emballagen kan ikke steriliseres.

> Rengør, desinficér og smør det medicinske udstyr.
> Sterilisér det medicinske udstyr.

3. Produktbeskrivelse

Håndstykke/vinkelstykke

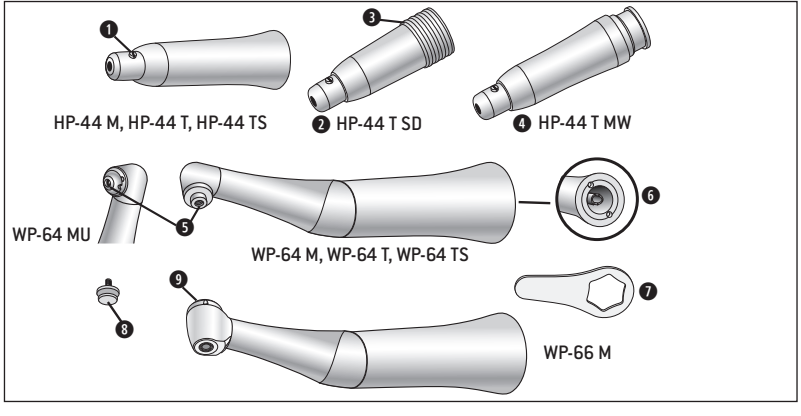

1. Tud
2. StarDental® tilslutning
3. Skydehylster
4. Midwest® tilslutning
5. Gevind
6. Aksel
7. Nøgle
8. Snap-on-adapter
9. Trykknap (WP-66 M)

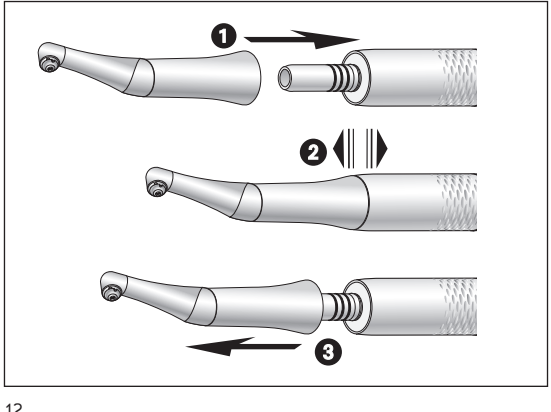

ISO-tilslutning

Ingen påsætning eller aftagning af det medicinske udstyr under drift!

❶ Sæt det medicinske udstyr på motoren.

❷ Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.

❸ Tag det medicinske udstyr af.

HP-44 TS, WP-64 TS må kun bruges på dentalmotorer, hvis ISO-koblinger har en længde på 23 mm eller derunder.

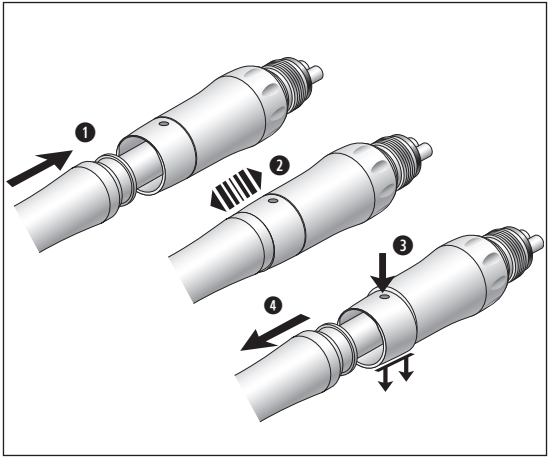

Midwest® tilslutning

Ingen påsætning eller aftagning af det medicinske udstyr under drift!

❶ Sæt det medicinske udstyr på motoren.

❷ Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.

❸ Tryk på motorhylsteret.
❹ Tag det medicinske udstyr af.

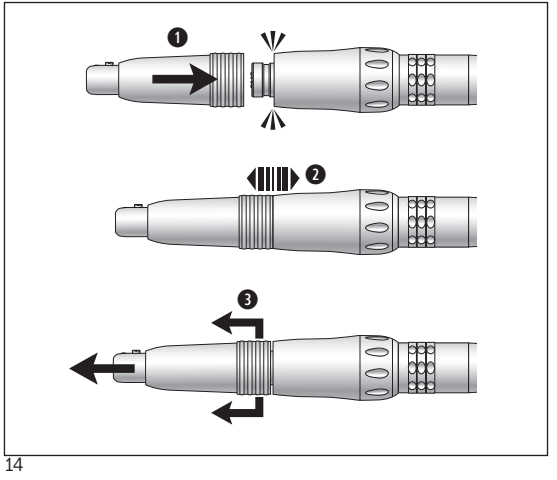

StarDental® tilslutning

Ingen påsætning eller aftagning af det medicinske udstyr under drift!

❶ Sæt det medicinske udstyr på motoren.

❷ Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.

❸ Betjen det medicinske udstyrs skydehylster for at tage det af motoren.

Roterende instrumenter

> Prophy-engangsvinkelstykke med bæger eller børste
> Prophy-bæger eller børste
> Snap-on-adapter til Prophy-bæger eller børste

> De roterende instrumenter er engangsartikler og skal udskiftes efter hver behandling!

> Brug kun fejlfri roterende instrumenter. Følg producentens anvisninger.
> Brug kun roterende instrumenter (til WP-66 M) hvis skafter overholder standarden ISO 1797.
> Sæt kun det roterende instrument i, når det medicinske udstyr står stille.
> Rør aldrig ved et roterende instrument, der kører eller er ved at standse.

> Anvend kun det medicinske udstyr i højregang. I venstregang kan det roterende instrument løsne sig (fare for personskade).
> Aktivér aldrig det medicinske udstyrs fastspændingssystem mens det er i brug. Dette medfører, at det roterende instrument løsnes, at fastspændingssystemet beskadiges, og/eller at det medicinske udstyr bliver varmt. Fare for forbrænding!

HP-44 M, HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD (Prophy-engangsvinkelstykke med plasticaksler, system Doriot)

> Til Doriot-systemet må du kun bruge Prophy-engangsvinkelstykker med plasticaksler. Prophy-engangsvinkelstykker med metalaksler beskadiger klemmefastspændingssystemet.

> Følg anvisningerne fra producenten af engangsvinkelstykker.

> Håndstykket har et automatisk klemmespændesystem.

Vinkelstykke WP-64 M, WP-64 T, WP-64 TS (system Young)

> Vinkelstykkehovedet er udstyret med en Triple-Seal-tætning fra Young Dental.
> Brug kun Prophy-bægre eller børster fra Young Dental til screw-in-systemet for at sikre tætheden.

Vinkelstykke WP-64 MU (system Universal)

> Vinkelstykkehovedet er udstyret med en W&H-tætning.
Du kan bruge alle gængse screw-in (skruegevind 1-72 UNF 2A) samt snap-on Prophy-bægre eller børster.

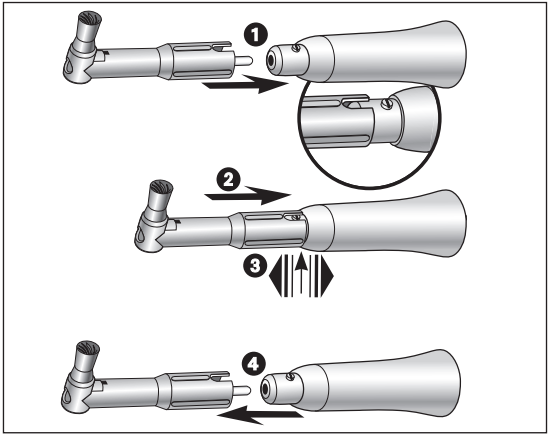

Håndstykke HP-44 M, HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD

> Prophy-engangsvinkelstykke med bæger eller børste

❶ Positionér rillen på engangsvinkelstykket ud for håndstykkets tud.

❷ Sæt engangsvinkelstykket på håndstykket, indtil det går i hak.

❸ Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.

❹ Tag engangsvinkelstykket af.

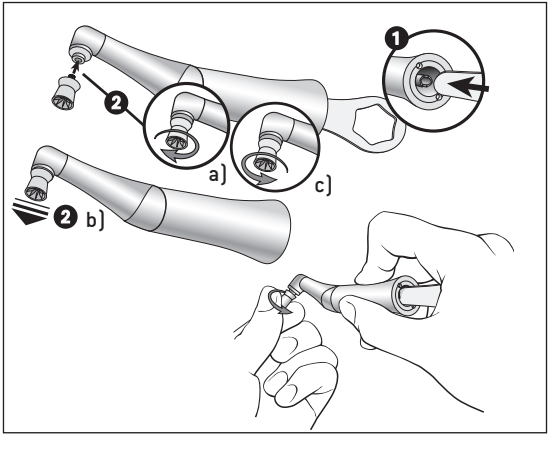

Vinkelstykke WP-64 M, WP-64 MU, WP-64 T, WP-64 TS

> Prophy-bæger eller børste

❶ Bloker vinkelstykkets aksel med nøglen.

❷ a) Skru bægeret eller børsten i indtil anslaget.

b) Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.

c) Skru bægeret eller børsten ud.

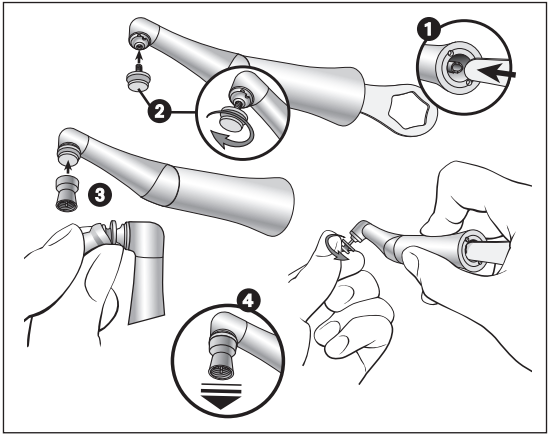

Vinkelstykke WP-64 MU

> Snap-on-adapter
> Prophy-bæger eller børste

❶ Bloker vinkelstykkets aksel med nøglen.
❷ Skru adapteren i indtil den falder i hak.
❸ Sæt bægeret eller børsten på adapteren.

❹ Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.

eller

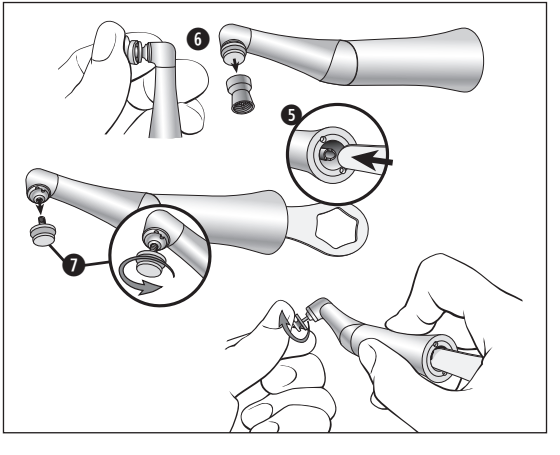

❺ Bloker vinkelstykkets aksel med nøglen.
❻ Tag bægeret eller børsten af adapteren.
❼ Skru adapteren ud.

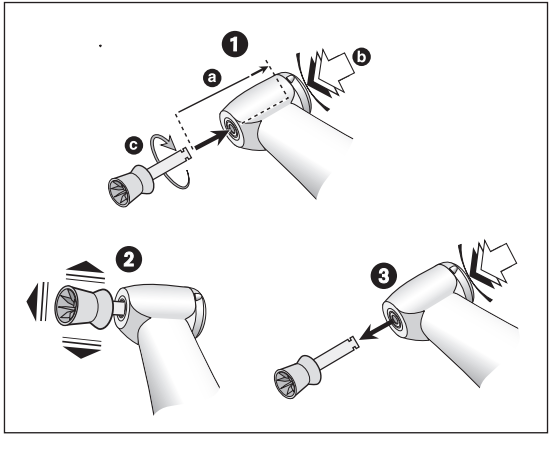

Vinkelstykke WP-66 M

> Prophy-bæger eller børste
> Diameter på instrumentets skaft 2,35 mm

❶ Skru bægeret eller børsten i indtil anslaget (a). Tryk på trykknappen (b) og drej samtidig bægeret eller børsten, indtil den går i hak (c).

❷ Kontrollér, at alting sidder forsvarligt fast.

❸ Tryk på trykknappen og tag bægeret eller børsten af.

Testkørsel

Hold ikke det medicinske udstyr i øjenhøjde!

> Indsæt det roterende instrument.
> Tag det medicinske udstyr i drift.

I tilfælde af driftsfejl (f.eks. vibrationer, unormale lyde, hvis instrumentet bliver varmt) **skal det medicinske udstyr straks tages ud af drift,** og du skal så henvende dig til en autoriseret W&H-servicepartner.

Vær opmærksom på dine lokale og nationale lovgivning, retningslinjer, normer og bestemmelser for rengøring, desinfektion og sterilisering.

Oplysningerne om den validerede oparbejdning fungerer som et eksemplarisk eksempel på en oparbejdning af det medicinske udstyr, som er i overensstemmelse med ISO 17664.

> Brug beskyttelsespåklædning, beskyttelsesbriller, beskyttelsesmaske og handsker.

> Brug kun oliefri, filtreret trykluft med et maksimalt driftstryk på 3 bar til manuel tørring.

Rengørings- og desinfektionsmidler

- > Følg oplysningerne, anvisningerne og advarslerne fra producenten af rengørings- og/eller desinfektionsmidlerne.
- > Brug kun vaske- og rengøringsmidler, som er beregnet til rengøring og/eller desinfektion af medicinsk udstyr af metal og plastic.
- > Overhold altid desinfektionsmiddelproducentens anvisninger vedrørende koncentrationerne og hvor længe midlet skal have tid til at virke.
- > Brug desinfektionsmidler, der er afprøvet af Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH = forbundet for anvendt hygiejne), Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP = det østrigske forbund for hygiejne, mikrobiologi og forebyggende medicin), Food and Drug Administration (FDA) og U.S. Environmental Protection Agency (EPA), og som disse organisationer anser for at være effektive.

Såfremt de anførte rengørings- og desinfektionsmidler ikke er til rådighed, bærer brugeren ansvaret for at validere sin metode.

Det medicinske udstyrs driftslevetid og funktionsevne afhænger i høj grad af den mekaniske belastning under brugen samt de kemiske påvirkninger i forbindelse med oparbejdningen.

> Send opbrugt eller beskadiget medicinsk udstyr og/eller væsentligt ændret medicinsk udstyr til en autoriseret W&H-servicepartner.

Oparbejdningscyklusser

> Ved det medicinske udstyr fra W&H anbefaler vi, at der fortages regelmæssig service efter 1.000 oparbejdningscyklusser eller efter ét år.

Rengør det medicinske udstyr straks efter hver behandling, så eventuelle indtrængte væsker (blod, spyt osv.) skylles ud, og for at undgå at de indvendige dele sætter sig fast.

> Lad det medicinske udstyr køre i tomgang i mindst 10 sekunder.
> Sørg for, at alle udgangsåbninger bliver skyllet igennem.

> Tør det medicinske udstyr helt af med desinfektionsmiddel.
> Tag det roterende instrument ud.
> Tag det medicinske udstyr af.

Vær opmærksom på, at det desinfektionsmiddel, der anvendes i forbindelse med forbehandlingen, kun er beregnet til personbeskyttelse, og at det ikke erstatter desinfektionstrinnet efter rengøringen.

Læg ikke det medicinske udstyr i desinfektionsopløsning eller ultralydsbad!

> Rengør det medicinske udstyr under rindende postevand (<35 °C/95 °F).
> Skyl og afbørst alle indvendige og udvendige overflader.
> Bevæg de bevægelige dele frem og tilbage flere gange.
> Fjern rester af væske med trykluft.

> W&H anbefaler aftørringsdesinfektion.

Det medicinske udstyrs egnethed til effektiv manuel desinfektion er blevet påvist af et uafhængigt testlaboratorie ved brug af desinfektionsmidlerne „mikrozid® AF wipes“ (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) og „CaviWipes™“ (Metrex).

W&H anbefaler maskinel rengøring og desinfektion med en rengørings- og desinfektionsmaskine (RDG). (undtaget HP-44 T, HP-44 TS, HP-44 T MW, HP-44 T SD, WP-64 T, WP-64 TS)

> Følg oplysningerne, anvisningerne og advarslerne fra producenten af rengørings- og desinfektionsmaskinerne samt rengørings- og/eller desinfektionsmidlerne.

Det medicinske udstyrs egnethed til effektiv maskinel desinfektion er blevet påvist af et uafhængigt testlaboratorie ved brug af rengørings- og desinfektionsmaskinen „Miele PG 8582 CD“ (Miele & Cie. KG, Gütersloh) og rengøringsmidlet „Dr. Weigert neodisher® MediClean forte“ (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamborg) i henhold til ISO 15883.

> Rengøring ved 55 °C (131 °F) – 5 minutter
> Desinfektion ved 93 °C (200 °F) – 5 minutter

> Sørg for, at det medicinske udstyr er helt tørt indvendigt og udvendigt efter rengøring og desinfektion.
> Fjern rester af væske med trykluft.

Kontrol

> Efter rengøring og desinfektion skal det medicinske udstyr kontrolleres for beskadigelser, synlige rester af snavs samt ændringer af overfladen.
> Gentag oparbejdningen på medicinsk udstyr, der stadigvæk er snavset.
> Sterilisér det medicinske udstyr efter rengøring, desinfektion og oliesmøring.

Oliesmøring

> Smør det tørre medicinske udstyr med olie straks efter rengøring og/eller desinfektion.
> Ret det medicinske udstyr nedad.

Anbefalede vedligeholdelsesrutiner

> Absolut nødvendigt efter hver indvendig rengøring
> Altid inden sterilisering

eller

> Efter 30 minutters brug eller en gang om dagen

Med W&H Service Oil F1, MD-400

> Følg instruktionerne på oliespraydåsen og emballagen.

eller

Med W&H Assistina

> Følg anvisningerne i Assistina-brugsanvisningen.

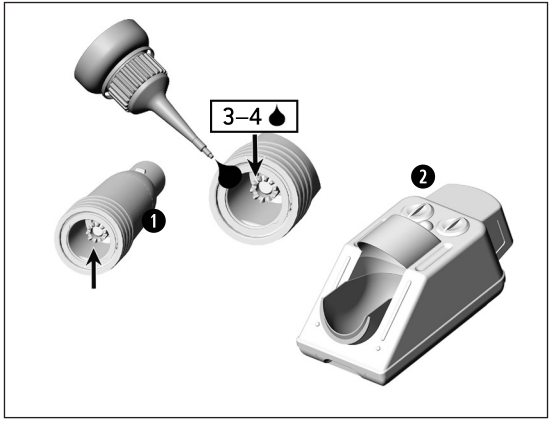

Daglig oliesmøring
HP-44 T SD

❶ Med W&H Service Oil F1, MD-30
> Kom 3 til 4 dråber i det medicinske udstyr.
> Foretag en testkørsel.

eller

❷ Med W&H Assistina
> Følg anvisningerne i Assistina-brugsanvisningen.
> Brug W&H-adapteren REF 07535400 (tilbehør) til StarDental® håndstykket.

Kontrol efter oliesmøring

> Ret det medicinske udstyr nedad.
> Tag det medicinske udstyr i drift, således at overskydende olie kan løbe ud.
> Overskydende olie kan medføre overophedning af det medicinske udstyr.

Pak det medicinske udstyr og tilbehøret ind i sterilvareforpakninger, der er i overensstemmelse med følgende krav:

> Sterilvareforpakningens kvalitet skal være i overensstemmelse med de gældende standarder, og den skal være egnet til steriliseringsmetoden.
> Sterilvareforpakningen skal være stor nok til den genstand, der skal steriliseres.
> Den fyldte sterilvareforpakning må ikke være under tryk.

W&H anbefaler sterilisering i henhold til EN 13060, EN 285 eller ANSI/AAMI ST55.

> Følg oplysningerne, anvisningerne og advarslerne fra producenten af dampsterilisatorerne.
> Det valgte program skal være egnet til det medicinske udstyr.

Anbefalet steriliseringsmetode

> "Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B) / "Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S)*/**
  134 °C (273 °F) i mindst 3 minutter, 132 °C (270 °F) i mindst 4 minutter
> "Gravity-displacement cycle" (type N)**
  121 °C (250 °F) i mindst 30 minutter
> Maksimal steriliseringstemperatur 135 °C (275 °F)

Det medicinske udstyrs egnethed til effektiv sterilisering er blevet påvist af et uafhængigt testlaboratorie ved brug af dampsterilisatoren LISA 517 B17L* (W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto (BG)), dampsterilisatoren Systec VE-150* (Systec) og dampsterilisatoren CertoClav MultiControl MC2-S09S273** (CertoClav GmbH, Traun).

"Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B):	134 °C (273 °F) – 3 minutter*, 132 °C (270 °F) – 4 minutter*/**
"Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S):	134 °C (273 °F) – 3 minutter*, 132 °C (270 °F) – 4 minutter*/**
"Gravity-displacement cycle" (type N):	121 °C (250 °F) – 30 minutter**

Tørretider:

"Dynamic-air-removal prevacuum cycle" (type B):	132 °C (270 °F) – 30 minutter**
"Steam-flush pressure-pulse cycle" (type S):	132 °C (270 °F) – 30 minutter**
"Gravity-displacement cycle" (type N):	121 °C (250 °F) – 30 minutter**

* EN 13060, EN 285, ISO 17665
** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79

> Opbevar de sterile genstande støvfrit og tørt.
> De sterile genstandes holdbarhed afhænger af opbevaringsbetingelserne og emballagen.

6. Service

Reparation og returforsendelse
I tilfælde af driftsfejl skal du straks henvende dig til en autoriseret W&H-servicepartner.
Reparationer og service må kun udføres af en autoriseret W&H-servicepartner.

> Sørg for, at det medicinske udstyr har gennemgået hele oparbejdningsprocessen forud for returforsendelsen.

7. Tilbehør, forbrugsmaterialer, reservedele og andet anbefalet medicinsk udstyr fra W&H

Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele fra W&H eller tilbehør, der er godkendt af W&H.
Leverandør: W&H Partner

000301xx	W&H Assistina
30310000	W&H Assistina TWIN (MB-302)
03103500	Assistina-adapter til W&H- og Midwest® håndstykker
07535400	Assistina-adapter til StarDental® håndstykker
03304500	Service Oil F1, MD-30
10940021	W&H Service Oil F1, MD-400 (6 stk.)
02038200	Sprayadapter til hånd- og vinkelstykker
01957300	Nøgle
04530600	Snap-on-adapter (WP-64 MU)
07979710	Prophy-engangsvinkelstykke med bæger, 105°, fast/mørkegrønt (100 stk.)
07994950	Prophy-engangsvinkelstykke med bæger, 105°, blødt/æblegrønt (100 stk.)

Du finder et udvalg af Prophy-engangsvinkelstykker, Prophy-bægre eller børster på W&H's eller Young Dentals hjemmeside:

http://wh.com
www.youngdental.com

eller

hos dit dentallager

8. Tekniske data

		HP-44 T WP-64 T	WP-66 M	HP-44 M WP-64 M WP-64 MU	HP-44 TS WP-64 TS	HP-44 T SD HP-44 T MW
Motortilslutning i henhold	til standard	ISO 3964	ISO 3964	ISO 3964	–	StarDental®* eller Midwest®*
Motortilslutning med maks. længde på 23 mm	til standard	–	–	–	ISO 3964	–
Håndgrebsmuffens udvendige diameter	(mm)	18	20	20	18	–
Diameter på instrumentets skaft	ISO 1797 (mm)	–	2,35	–	–	–
Gearforhold		4:1				
Maksimalt omdrejningstal	(min^{-1})	10 000				
Maksimalt omdrejningstal på roterende instrument	(min^{-1})	2 500				

min^{-1} (omdrejninger i minuttet)

* StarDental® er et registreret mærke tilhørende DENTALEZ Inc.
* Midwest® er et registreret mærke tilhørende Dentsply International Inc.

Temperaturoplysninger

Det medicinske udstyrs temperatur på brugersiden:	maksimalt 55 °C (131 °F)
Det medicinske udstyrs temperatur på patientsiden:	maksimalt 50 °C (122 °F)
Den arbejdende dels (roterende instrument) temperatur:	maksimalt 41 °C (105,8 °F)

Omgivelsesbetingelser

Temperatur under opbevaring og transport:	-40 °C til +70 °C (-40 °F til +158 °F)
Luftfugtighed under opbevaring og transport:	8 % til 80 % (relativ), ikke kondenserende
Temperatur under brug:	+10 °C til +35 °C (+50 °F til +95 °F)
Luftfugtighed under brug:	15 % til 80 % (relativ), ikke kondenserende

9. Bortskaffelse

Sørg for, at delene ikke er kontaminerede, når de bortskaffes.

Vær opmærksom på dine lokale og nationale lovgivning, retningslinjer, normer og bestemmelser for bortskaffelse.

> Medicinsk udstyr
> Emballage

Garantibevis

Dette medicinske udstyr fra W&H er fremstillet med stor omhu af højt kvalificerede fagfolk. En lang række forskellige tests og kontroller garanterer problemfri funktion. Du bedes være opmærksom på, at garantikravene kun gælder, når alle anvisninger i den vedlagte brugsanvisning bliver overholdt.

W&H påtager sig som producent ansvaret for materiale- eller produktionsfejl fra købsdatoen inden for en garantiperiode på 24 måneder. Garantien dækker ikke tilbehør og forbrugsmaterialer (nøgle og snap-on-adapter).

Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader som følge af usagkyndig behandling eller i tilfælde af reparationer udført af tredjemand, der ikke er autoriseret af W&H.

Garantikrav skal rettes til leverandørerne eller en autoriseret W&H-servicepartner og købsnotaen skal vedlægges. I tilfælde af at der ydes garanti, vil dette hverken forlænge garantien eller en eventuel forældelsesfrist for mangelsbeføjelser.

24 måneders garanti

Autoriseret W&H-servicepartner

Besøg W&H på internettet på http://wh.com
Under menupunktet "Service" finder du nærmeste autoriserede W&H-servicepartner.

Eller scan QR-koden.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, **Austria**

t +43 6274 6236-0,
office@wh.com

f +43 6274 6236-55
wh.com

Form-Nr. 50815 ADK
Rev. 003 / 24.07.2023
Ret til ændringer forbeholdes