

#whdentalwerk
f @ m ▶
video.wh.com


Agora em seu
representante local
ou em wh.com



Sistema de pontas Piezo.

Durável. Seguro. Eficiente.

De profissionais para
profissionais.

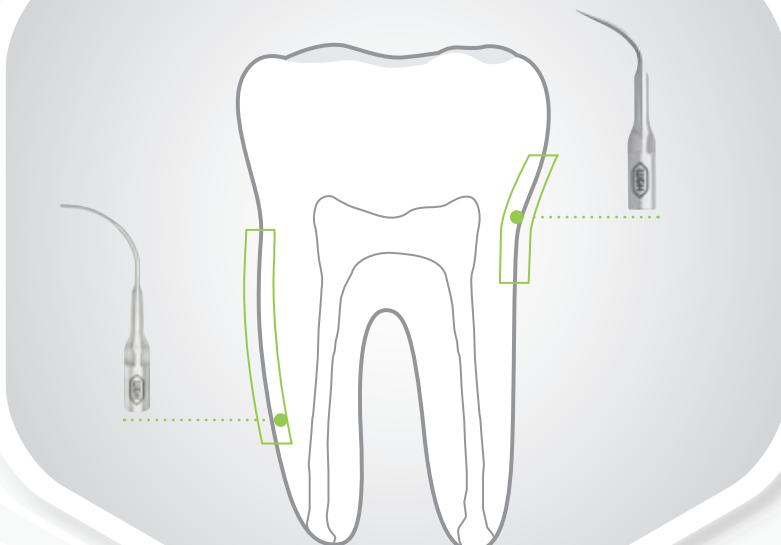

Sistema de Pontas Piezo da W&H

O sistema de pontas da W&H foi desenvolvido em colaboração com usuários finais e desenhado especialmente para os requisitos técnicos da tecnologia Piezo da W&H.

É perfeito para as respectivas áreas de aplicação e adequado para cada etapa de tratamento.



Higiene e manutenção

Todas as pontas e substituidores de pontas são desinfetáveis termicamente e esterilizáveis.



135°C



Utilização rápida, simples e segura

O substituidor de pontas W&H permite uma utilização rápida e segura. O controle de torque integrado previne um apertamento excessivo e facilita a troca das pontas com facilidade e segurança.



Cartão de pontas do ultrassom piezoeletrico

Nem mesmo as pontas W&H são resistentes ao desgaste do material. Com a ajuda do cartão de pontas, o comprimento da ponta pode ser verificado usando a linha vermelha, podendo deste modo ser assegurada uma substituição oportuna.




A questão é a segurança



Utilize apenas pontas e o respectivo trocador de pontas ou chave de boca autorizados pela W&H:


- › O dispositivo médico com pontas periodontais é adequado para remover cálculo e placa em áreas subgengivais; mas não para aplicações que requerem condições estéreis. Para tratamentos periodontais de pacientes hipersensíveis, escolha a faixa de potência inferior para garantir um tratamento indolor e ideal.
- › Certifique-se de que a forma original das pontas não se altera (por exemplo, devido à queda).
- › As pontas não devem ser dobradas e reafiadas.
- › Introduza a ponta apenas com o dispositivo médico parado.
- › Nunca toque na ponta oscilante.
- › Encaixe o trocador de ponta após cada manuseio na ponta utilizada do dispositivo médico parado (proteção contra lesões e infecções, proteção da ponta). As pontas que forem trocadas com a chave de boca devem ser removidas do dispositivo médico imediatamente após o tratamento.
- › Nunca toque no trocador de pontas (com a ponta inserida).
- › Verifique o desgaste das pontas com o cartão de pontas fornecido.
- › Substitua as pontas quando o desgaste do material for visível.

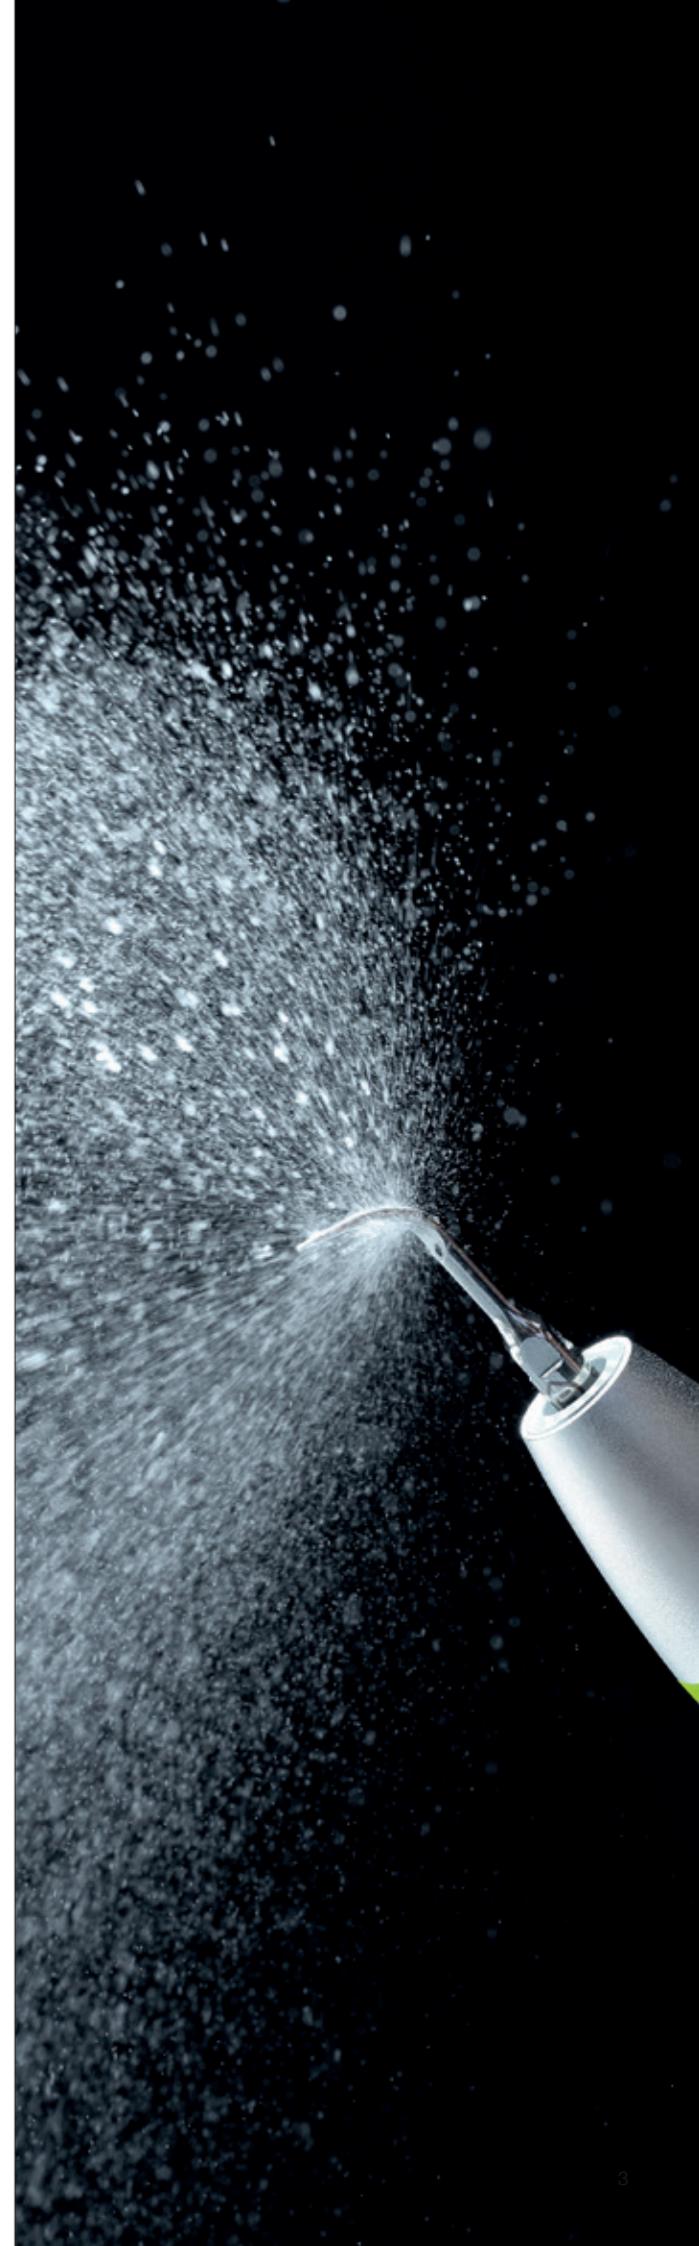

Curva de potência e ângulo de trabalho

50% da configuração do dispositivo ≠ 50% da potência

Para um ajuste de potência mais preciso na faixa de potência mais baixa. Preste atenção aos ajustes de potência recomendados das pontas para obter os melhores resultados possíveis.



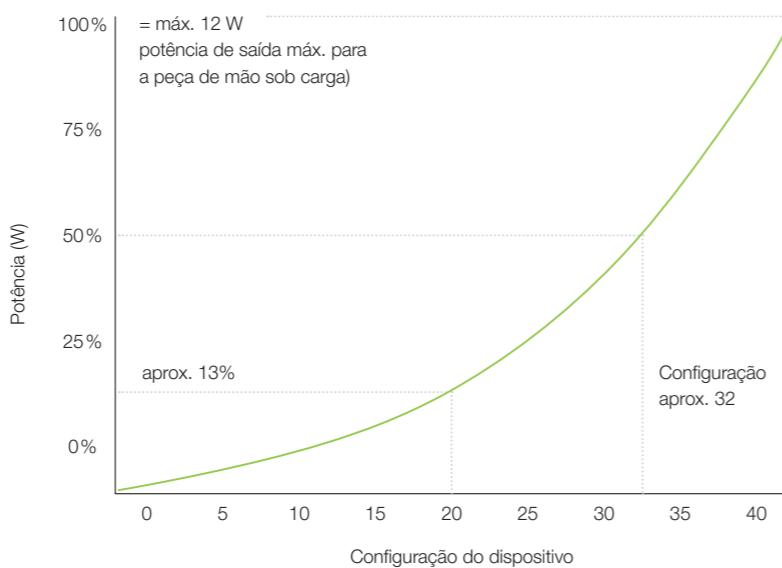


Remoção de placa

Periodontia

Raspagem Pontas Universais

Remoção simples, eficiente e cuidadosa de todo cálculo dental supra-gengival. Para todos os quadrantes.

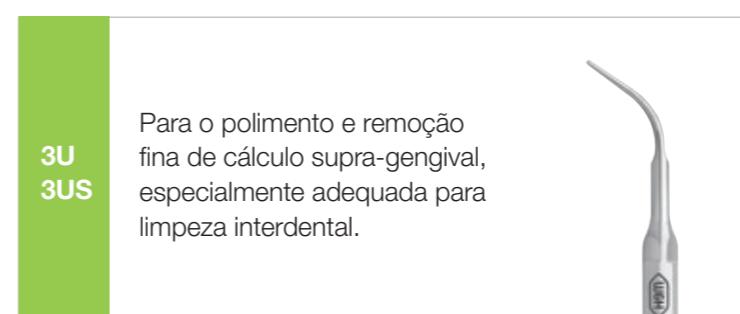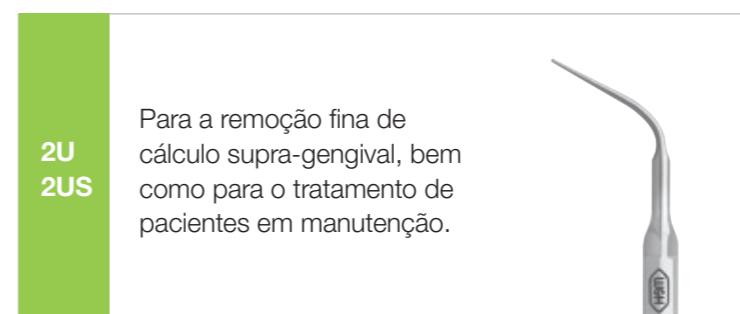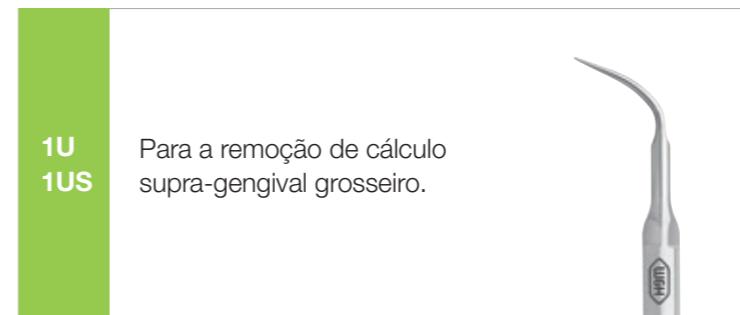

Potência:
ideal 30 (40%)
máx. 40 (100%)

Água:
ideal 60%-100%

Potência:
ideal 20 (13%)
máx. 30 (40%)

Água:
ideal 60%-100%

Potência:
ideal 20 (13%)
máx. 30 (40%)







Água:
ideal 60%-100%

Paro

Pontas de Periodontia

Para Terapia Periodontal de Suporte (TPS), manutenção e controle de biofilme.

A sua forma delgada facilita um acesso ideal e atraumático às bolsas periodontais.

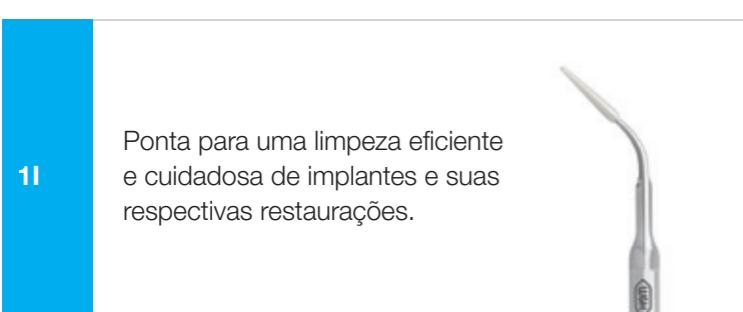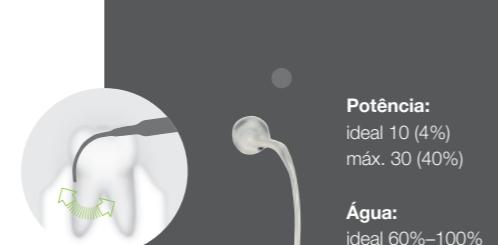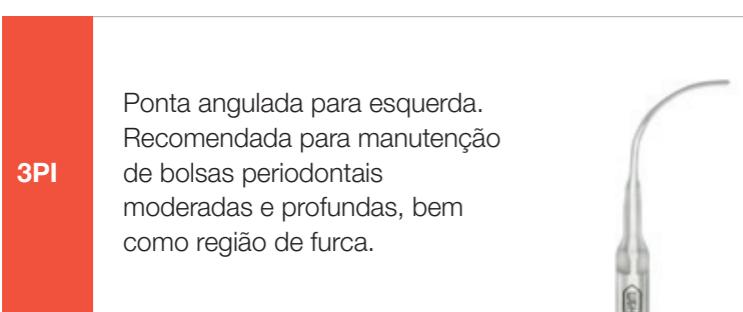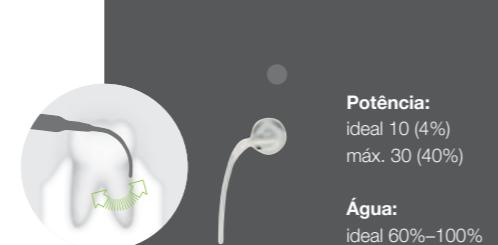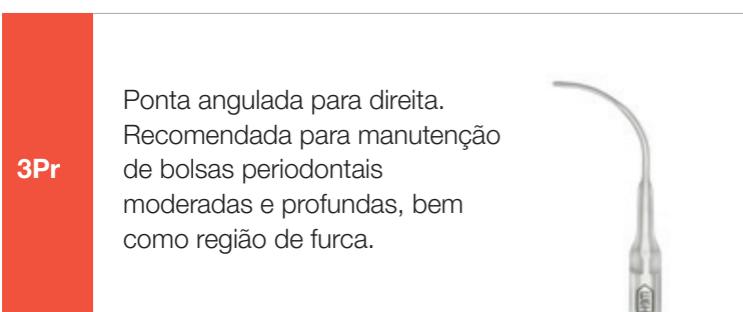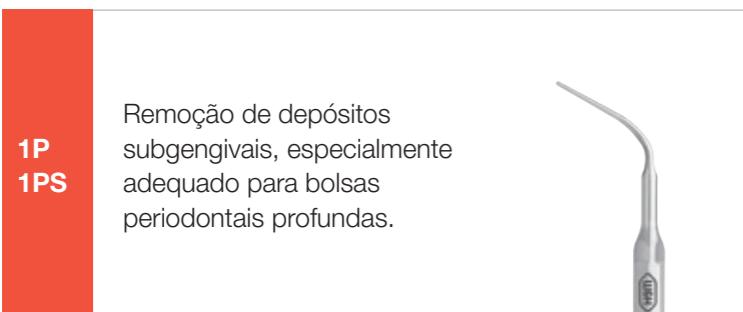

Compatibilidade

das pontas com as peças de mão W&H



	W&H/EMS/Mectron	W&H/NSK/Satelec*		
	PB-5 L	PB-3	PB-5 L S	PB-3 S
Proxeo Ultra	X		X	
Built-in	X	X	X	X

* As pontas W&H com rosca Satelec (por ex. 1US, 2US) são compatíveis com as peças de mão PB-5 L S, PB-3 LED S e PB-3 S da W&H.

** Nota: EMS®, Mectron®, NSK® e Satelec® são marcas comerciais de terceiros que não são afiliadas à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Sempre que usar pontas de outros fornecedores, o usuário é responsável por garantir a configuração correta dos parâmetros de operação do dispositivo piezoelettrico W&H.

Ângulo de trabalho correto para as peças de mão Proxeo Ultra

Devido à oscilação linear da ponta (para frente e para trás), o ângulo de ataque deve ser tal que a ponta fique alinhada paralelamente à superfície do dente.




W&H AIMS Segurança em primeiro lugar!

aims Advanced
Infection Prevention
Management Solutions

A higiene é de extrema importância na prática odontológica. O AIMS da W&H está aqui para apoiá-lo: com um amplo portfólio de produtos, conhecimento básico e todas as informações relevantes em um relance.

Para a sua segurança e a segurança dos seus pacientes.

aims.wh.com

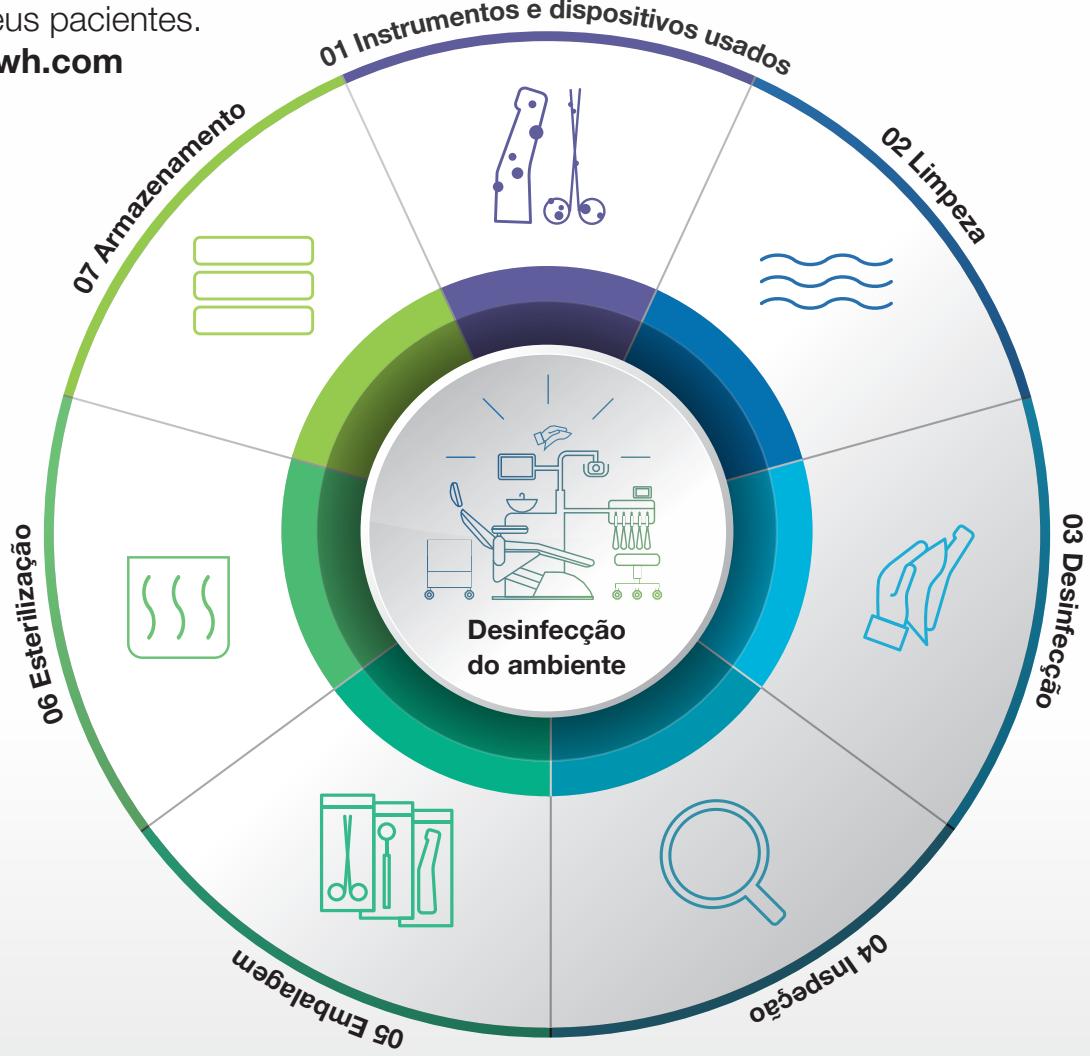

Fabricante:

W&H Dentalwerk Büromoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1

5111 Büromoos, **Austria**

t +43 6274 6236-0

f +43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com

Imagens meramente ilustrativas. Acessórios e equipamentos adicionais não estão inclusos no material fornecido.

20313 APOB Rev. 003 / 09.12.2025
Sujeito a alterações